■高精度型体組成計　DF851-MTG 仕様

電源	AC100V　±10%　50/60Hz
消費電流	体組成測定時 220mA 印字時平均 1.7A（最大4A）
外形寸法	約(W)290×(D)600×(H)880mm
重量	約15kg
外部インターフェイス	RS-232C出力(D-sub9ピン　オス)
印字方式	ラインサーマルドット印字
印字用紙寸法	幅 58mm×φ50(MAX)mm

セット販売価格：¥600,000(¥630,000)

ハード販売価格：¥350,000(¥367,500)　ソフト販売価格：¥250,000(¥262,500)

■顧客管理ソフト FINE fitness 仕様

対応OS	WindowsXP　Pack2(Vista未対応)
対応PC	富士通、NEC、DELL社製のPC
メモリ	512MB以上
ハードディスク	30GB以上
USB	USB2以上
必要ソフト	Microsoft Office Word
接続ケーブル	①RS-232Cリバースケーブル ②RS−232C−USB変換ケーブル （PCの接続端子によって①②の2本必要と①のみ1本必要に分かれます） ※接続ケーブルは別途ご購入ください。付属品には含まれていません。
顧客登録人数	ハードディスクの空き容量分
その他	高精度型体組成計DF851を必ずご用意ください

※表示価格は税抜きのメーカー希望小売価格。( )内は税込み価格です。※製品改良のため、仕様は予告なく変更になる場合があります。

⚠ 危険

下記のような医用電子機器との併用は絶対にしないでください。
これらの機器が誤動作を起こす原因になります。

- ●ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器
- ●人工心肺などの生命維持用電子機器
- ●心電計などの装着型医用電子機器

⚠ 注意

転倒する恐れがありますので本体の端に乗らないでください。
取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

本器の内臓脂肪断面積指数の推定算出は、体脂肪とウエスト周囲長（へそ高）を含む体格指数などを用いて、独自に腹部CTデータとの相関を高めた方式で行っています。本器の方式は内臓脂肪量そのものの全量を評価しているわけではありません。本器は医療器具ではありませんので、医学的診断については医師にご相談ください。本ソフトウェアは1店舗につき、1ソフトウェアでのご使用が条件となります。

発売元
株式会社MTG
〒453-0041 愛知県名古屋市中村区本陣通2丁目32番 MTG HIKARIビル
TEL.052-481-2707　FAX.052-481-2708　E-mail:info@mtg.gr.jp
www.mtg.gr.jp　www.mtg-life.jp

07N-071108

Dr.カルテ

高精度型体組成計 DF851-MTG

脱メタボリック＆ダイエット！
1台でカラダまるごとチェック!!

お客様の目的に合せたアドバイスから、測定履歴・顧客管理など店舗運営サポートにも役立ちます。

メタボリックが気になる！ ▶ 内臓脂肪チェック！ ▶ ダイエットしたい！ ▶ 体脂肪率・基礎代謝量チェック！ ▶ 足腰を鍛えたい！ ▶ 筋肉量(率)チェック！

画面を見ながらカンタンチェック！導入したその日からご活用いただけます。

体 重 | 体脂肪率（部位別・左右別） | BMI | 筋肉量(率) | 内臓脂肪 | 基礎代謝量 | 推定骨量 | 水分量

まだまだあります。

MTG

お客様ひとりひとりの測定管理からリピートへつなげる店舗運営サポートツール

会員登録 → **登録データは、DMなど広告・宣伝に活用！**

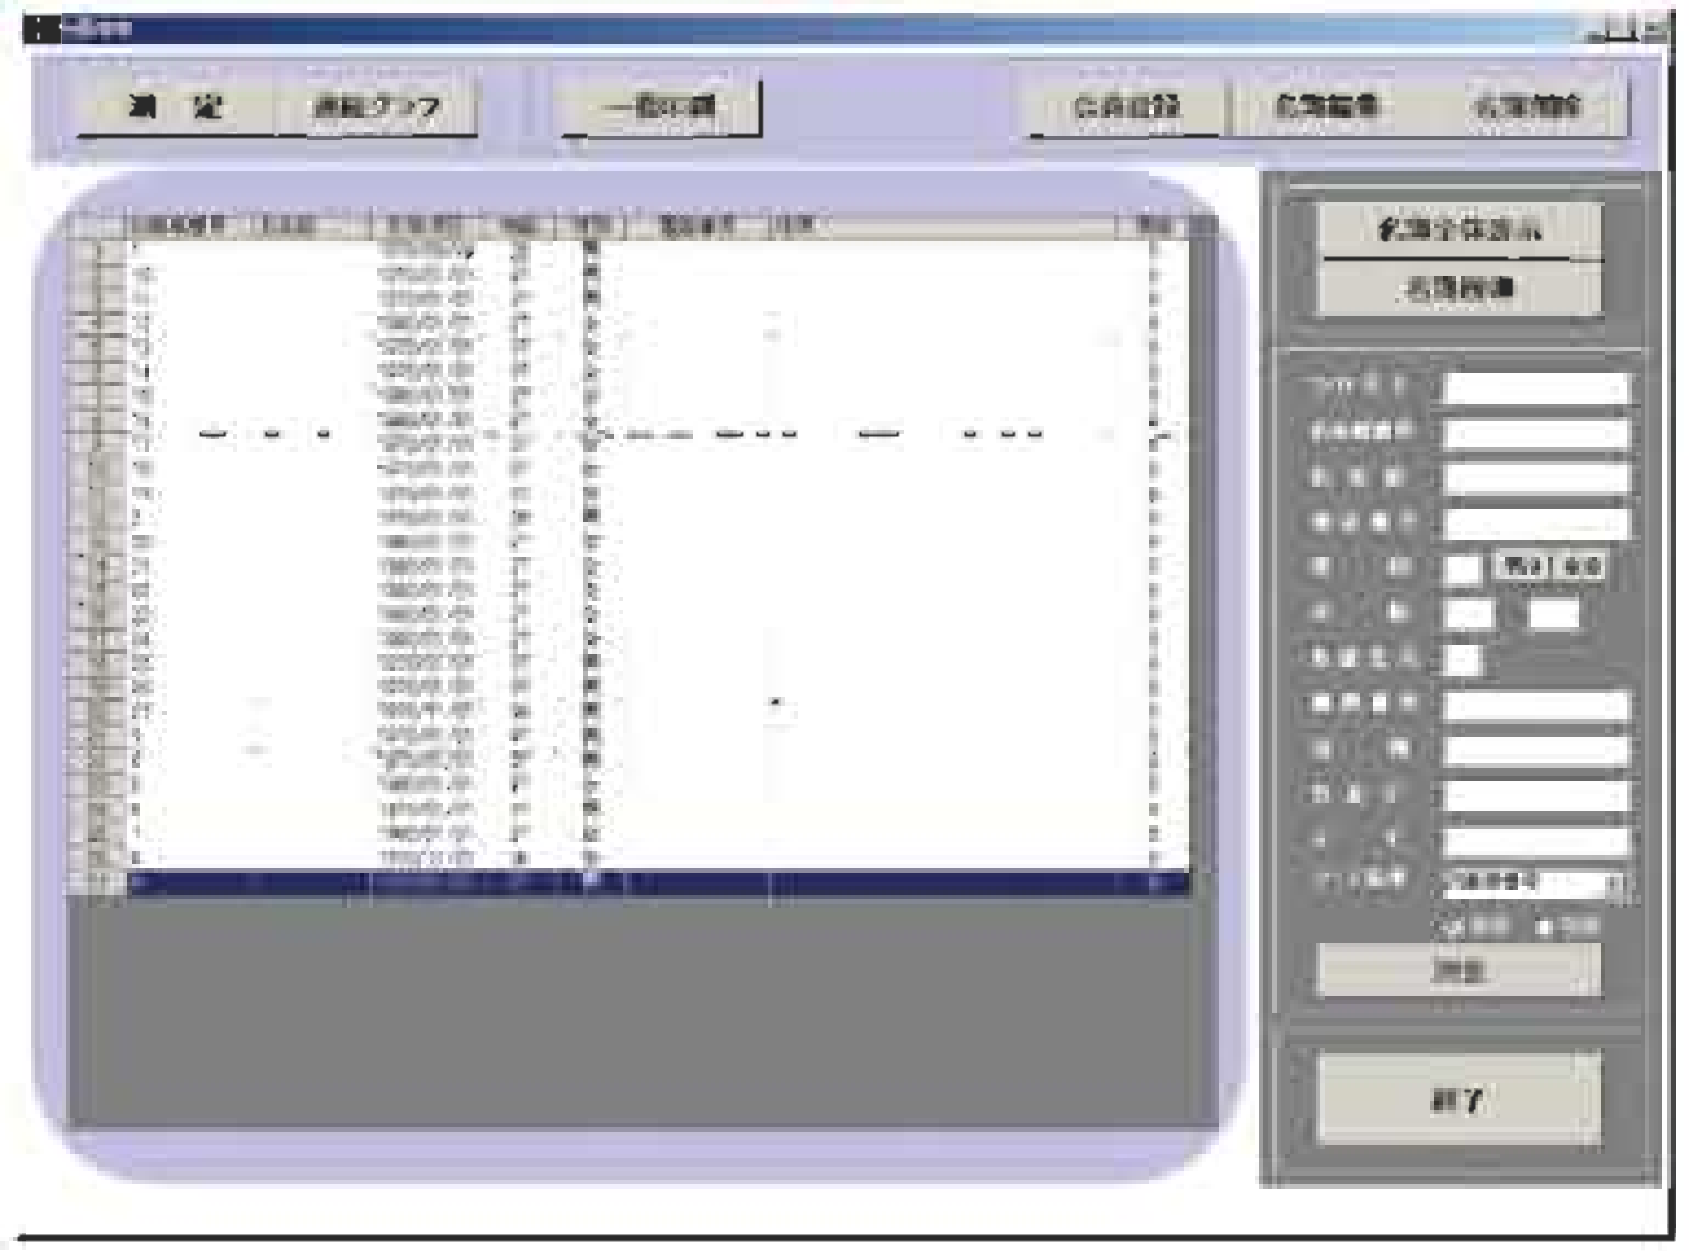

顧客管理機能が役立ちます。

会員検索画面で目的に合った会員を抽出できます。
例えば、年齢・性別・住所・来店回数など、入力情報を目的に合せて抽出できますので、ＤＭの効果的な送付など、幅広く活用できます。

測定結果をプリンターからプリント

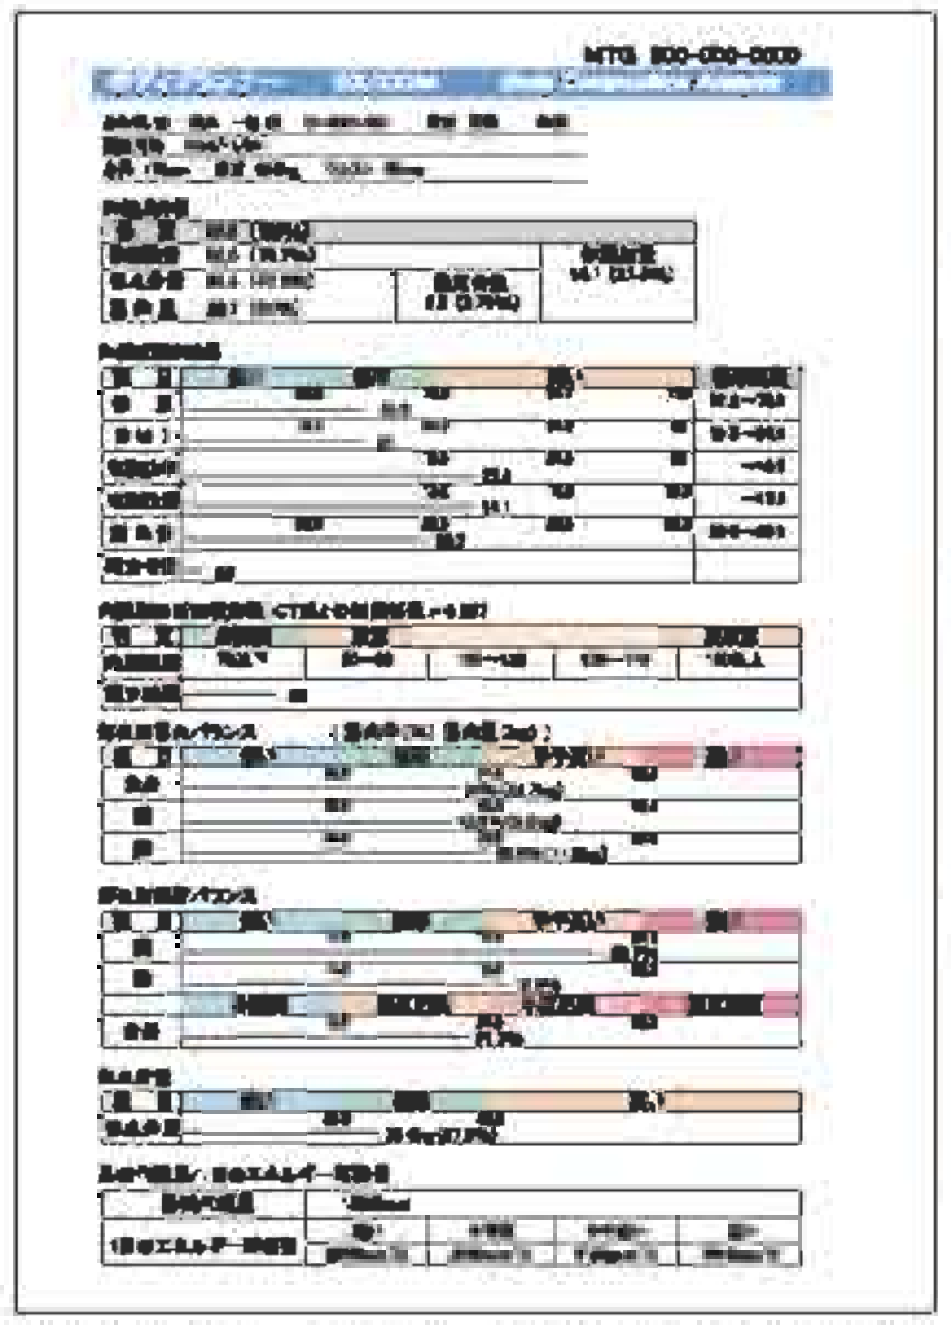

■総合分析プリントイメージ（A4コピー用紙対応）

- 総合分析
- 判定コメント
- 総合チャートグラフ
- 筋肉バランス
- タイプ判定
- 推移グラフ
- 測定履歴グラフ

多彩な画面表示で、測定結果を表示。カンタンにお客様へご説明いただけます。

①会員検索画面

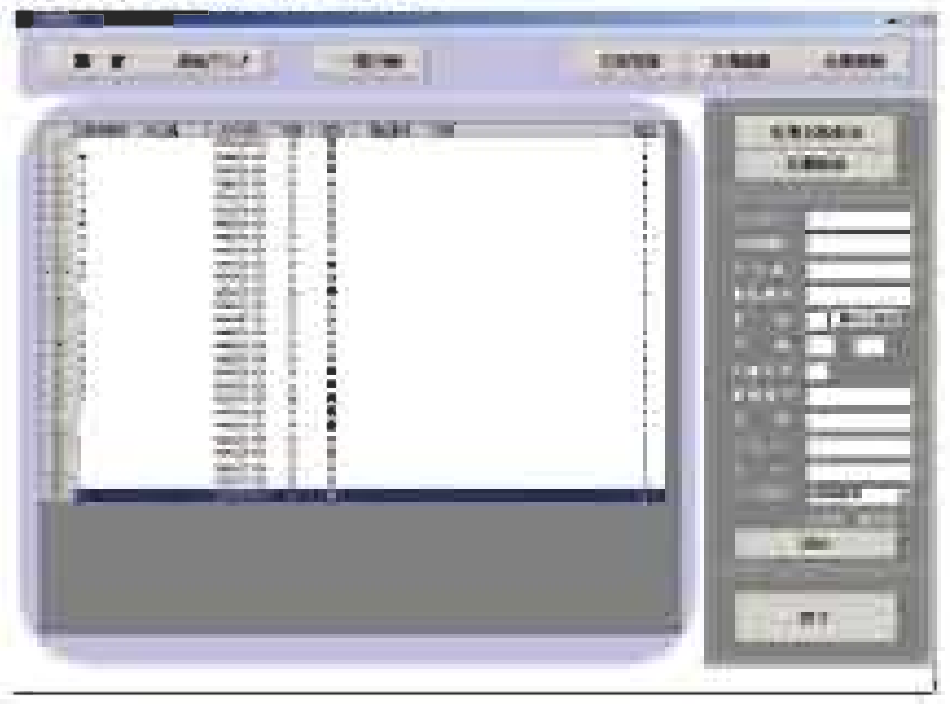

②総合チャートグラフ画面

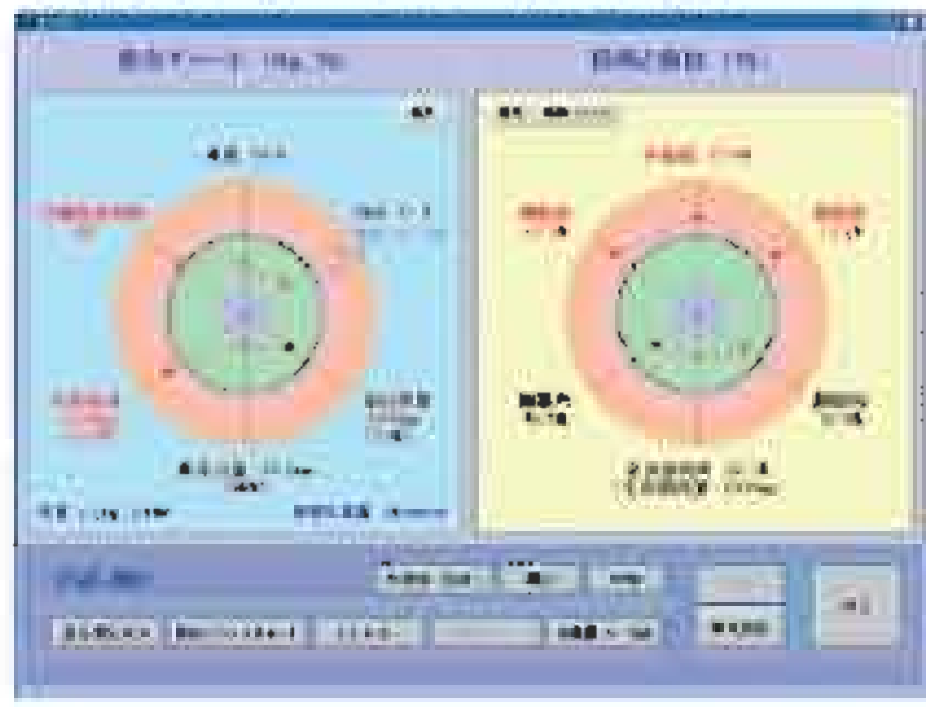

③測定履歴グラフ画面

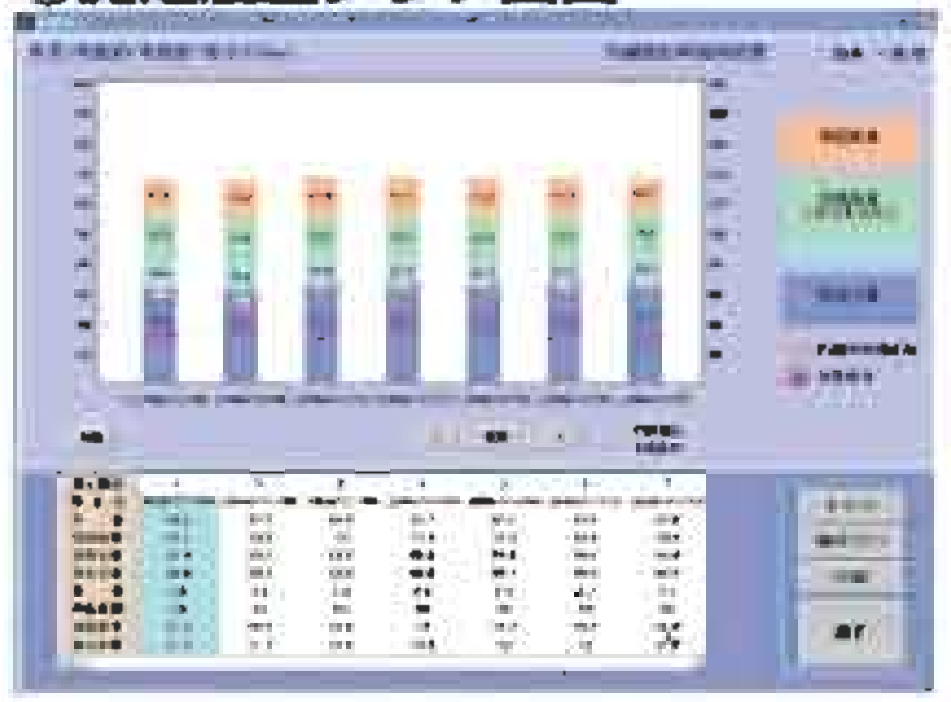

④体脂肪率とBMIからのタイプ判定画面

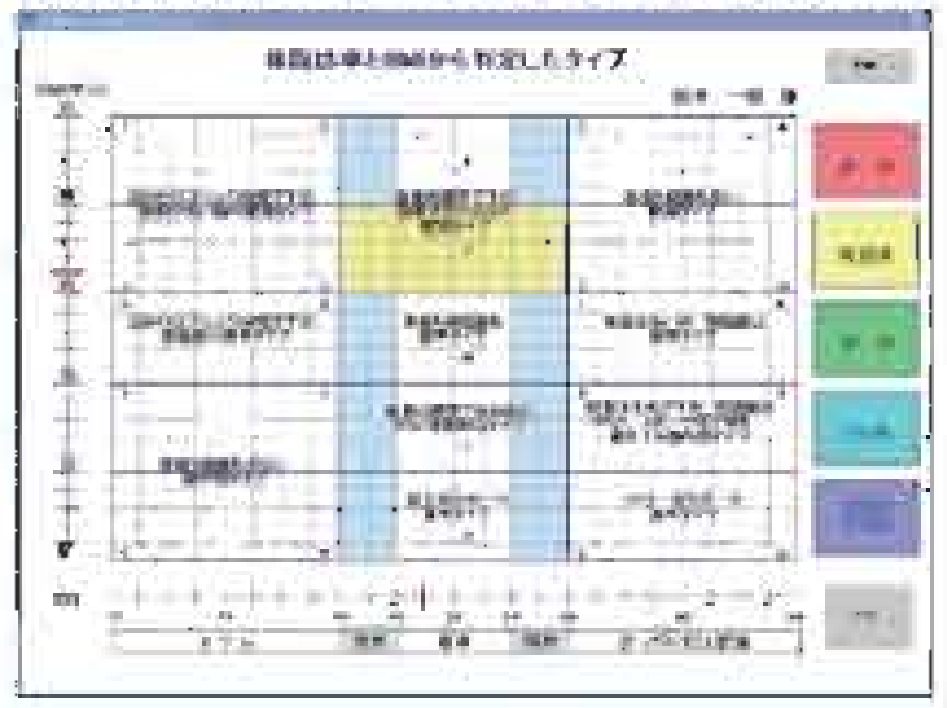

⑤筋肉バランス画面

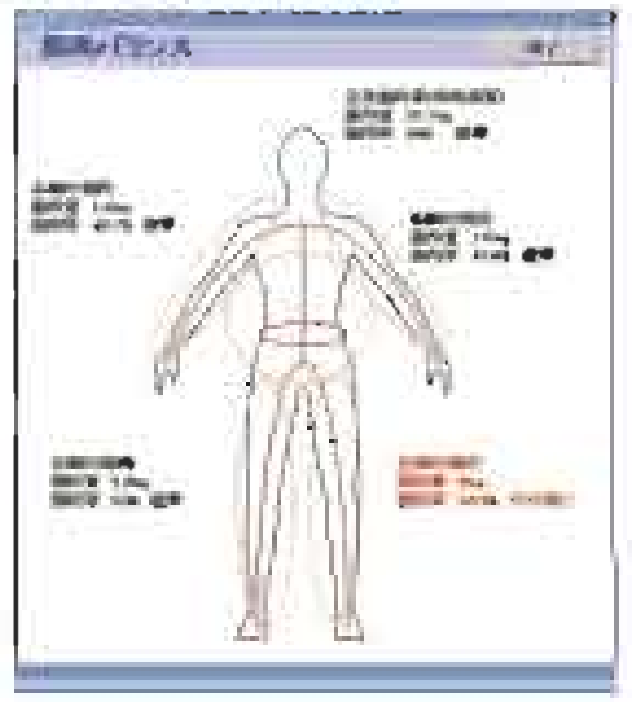

⑥筋肉バランスチャート画面

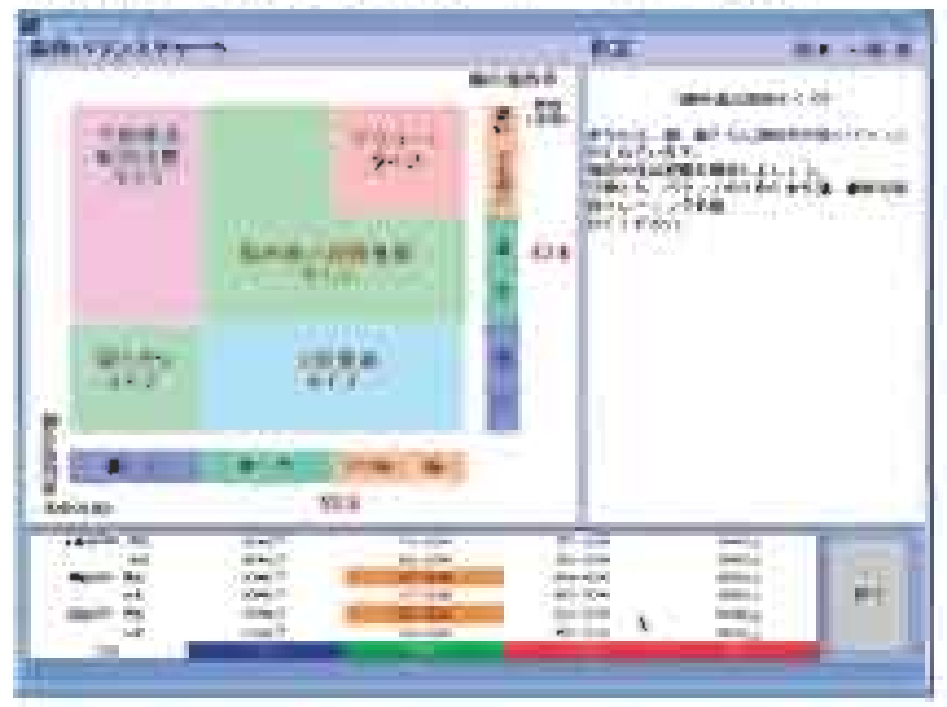

⑦判定コメント画面

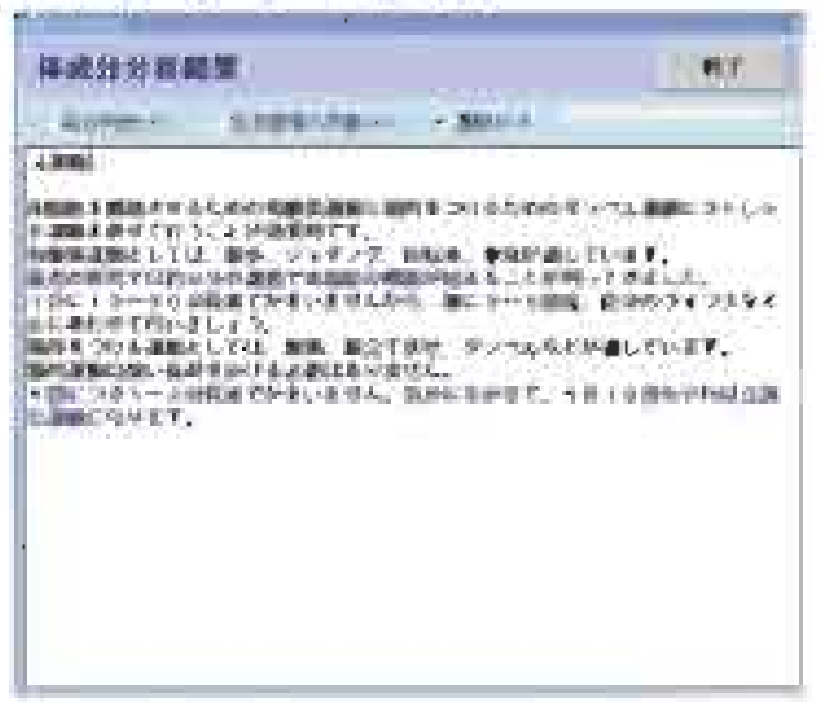

⑧体組成・筋肉推移グラフ画面

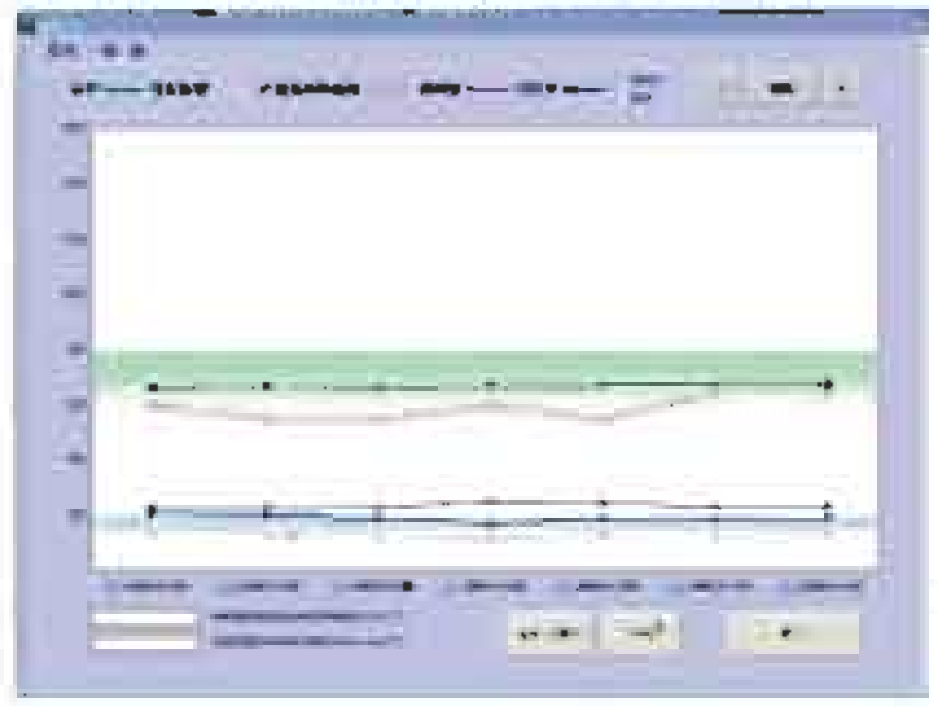

■簡易プリントイメージ
（８電極全身測定時）

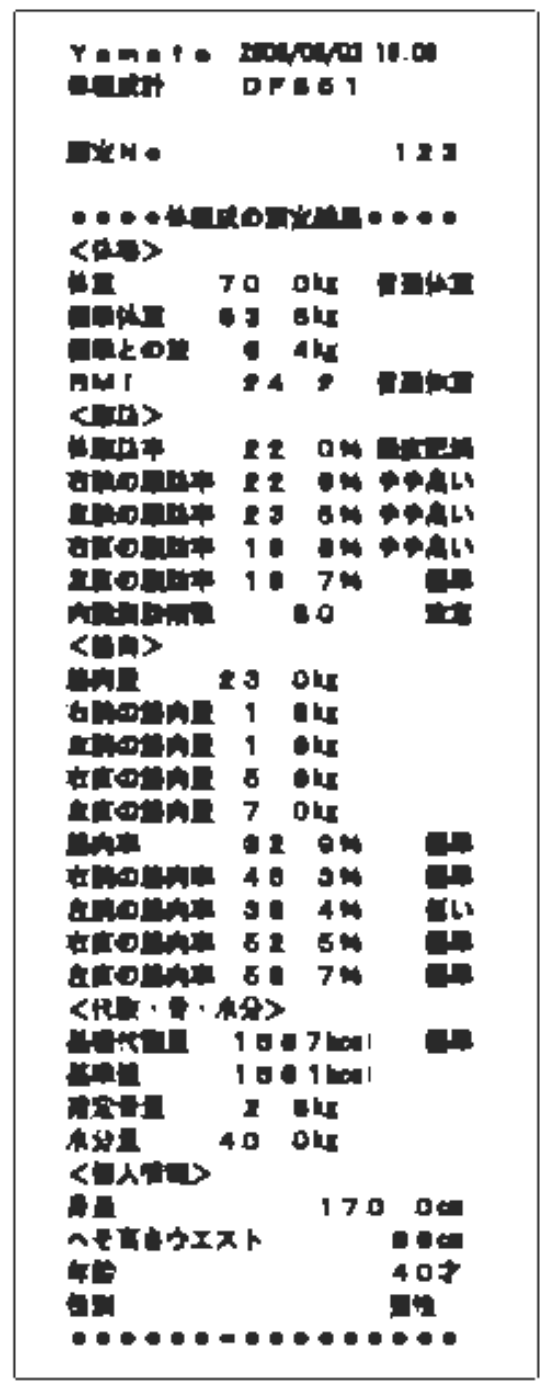

測定結果が画面に反映

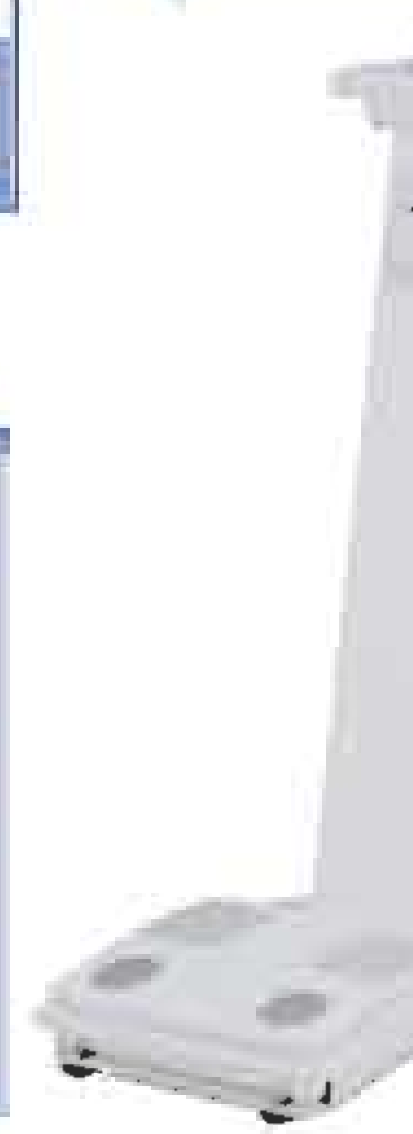

**業務用だから、より詳しく、
正確に測定できます。**

８電極全身測定方式

手・手間や足・足間だけを測定し、全身の体組成を推定する方法では、明らかに精度の限界があるだけでなく、測定者によっては誤差の大きなデータになることもあります。高精度型体組成計Dr.カルテはより正確さを求めて全身を8つの電極（8電極式）を設けて測定します。

部位別測定方式

**部位別・左右別の測定だから
高精度にカラダがわかる！**



全身測定方式において測定点を切替え、上肢左右、下肢左右と部位別情報を表示し、より詳細な測定を実現しました。

多周波測定方式

一般的な家庭用体脂肪計と違い、高精度型体組成計Dr.カルテは、細胞外と細胞内を分けて測定することで、精度の高い体組成を表示します。

多周波数方式

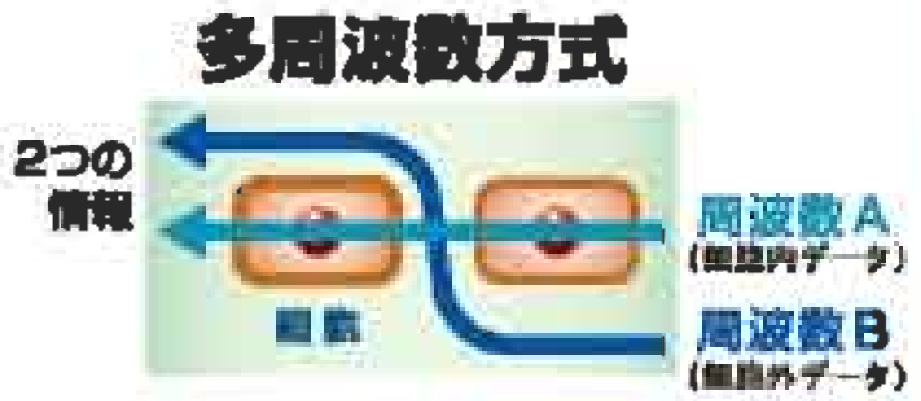

ウエスト自動計算モード

ウエスト入力なしでも計測できるウエスト自動計算モードを選択できます。ウエスト自動計算モードはウエストサイズを他の情報から自動で算出する簡易な使用方法です。

４電極モード

４電極への切り変えで、靴下を脱がなくても簡易測定できる４電極モードを選択できます。（本モード時は部位別の測定データは表示しません。）

※ウエスト自動計算モード、４電極モードに関しては体組成計本体のみでのご使用になります。（顧客管理ソフトへのデータの反映はされません。）